

## 多パラメータ差圧伝送器 JUN-E60

JUN-E60 多パラメータ差圧伝送器は、世界中で先進的な圧力センサ技術とパッケージング技術を採用し、丹精込めて開発された超高性能差圧伝送器です。測定精度が最大±0.075%、測定スパン比が 100:1 まで達しています。伝送器は単結晶シリコンセンサを内蔵し、測定圧力に応じたDC4~20mA 信号を出力します。パルス信号或い RS485 デジタル信号。製品は気体、液体、蒸気など各種流体の圧力測定に適応し、防爆必要とする環境に使用可能です。スマート端末との相互通信により、各種機能の設定、調整、出力信号を監視することができます。



### 標準仕様

#### 出力信号

- アナログ出力: DC4~20mA
- パルス信号
- RS485 MOUDBUS-RTU
- アナログ出力範囲: DC3.8~20.8mA (最大)

- 媒質測定温度範囲:
- シリコン充填センサ -40~120°C
- 不活性充填液 -45~160°C

#### 供給電源電圧

DC16.5~55V (図1をご参照ください)

#### 使用湿度範囲

5~100%RH@ 40°C

#### 負荷抵抗

- 0~2199Ω 動作状態 (図1をご参照ください)
- 250~600Ω HART 通信

#### 保管温度範囲

-40~110°C, 一体化 LCD 表示: -40~85°C

#### 保護等級

IP67

#### 測定圧力範囲

範囲コード	測定スパン	レンジ測定範囲
G06	6kPa	最低測定スパン200Pa, -6~6kPa
G40	40kPa	最低測定スパン400Pa, -40~40kPa
G250	250kPa	最低測定スパン2.5kPa, -250~250kPa
G1K	1MPa	最低測定スパン10kPa, -0.5~1MPa
G3K	3MPa	最低測定スパン30kPa, -0.5~3MPa
G10K	10MPa	最低測定スパン100kPa, -0.5~10MPa

#### 故障警報信号

圧力は上下限界を超える場合、警報電流値を出力します。下限は 3.8mA 迄、上限は 20.8mA 迄です。

#### 精度

±0.075%, ±0.1% (表2をご参照ください)

#### 温度補償

外接三線制 PT100 熱電気抵抗を通じて温度補償を実現する

#### 最大使用圧力

表1をご参照ください

#### 温度特性

-20~80°C範囲内影響程度: ±(0.1+0.1TD)%  
測定上限

#### 耐圧力

表1をご参照ください

#### 時間指標

総ダンピング時定数は、電気回路部品とセンサフィルムボックスのダンピングの時定数の合計に

#### 使用温度範囲

- 使用環境温度範囲: -40~85°C
- 一体化 LCD 表示: -20~70°C

なります。電気回路部品のダンピング時定数：0～100S。  
センサフィ ルムボックスのダンピング時定数：≤0.2S

### 長期安定性

±0.15% 測定スパン上限/10年

### ショートカットメニュー

機能	説明
PV リセット	現模擬出力の圧力値をゼロにリセット
ゼロ調整	使用参考圧力標定実際出力は 4mA
満点調整	使用参考圧力標定実際出力は 20mA
初期化設置	デバッグでエラーが出た場合、バックアップされたデータを復元する

### 材質

各種防腐材質の接液部を提供できます。  
接液部隔膜材質：316L ステンレス鋼、316L ステンレス鋼メッキ、ハルメタルC、タンタル、モネル等。  
O型密封リンク材質：ニトリルゴム、フッ素ゴム、テフロン  
配線ボックス材質：表面にエポキシ樹脂で塗装されたアルミニウム合金 フランジ、排気排液弁材質： 316L ステンレス鋼

### 封入液

シリコンオイル、不活性充填液など

### 圧力導入接口

雌ネジ 1/4T-18NPT

### 配線接口

M20\*1.5、1/2 NPT

### 重量

約 4 kg (取付スタンド、プロセス接続付属品を含まない)

## 付加説明

### ATEX 隔爆認証

II 級、1/2 区、G 組、Ex db IIC T6 Ga/Gb -30°C ≤ 周囲温度 (Tamb) ≤ +75°C  
過程温度 (Tprocess) ≤ 85°C  
II 級、1/2 区、G 組、Ex db IIC T5 Ga/Gb -30°C ≤ 周囲温度 (Tamb) ≤ +80°C  
過程温度 (Tprocess) ≤ 100°C  
II 級、2 区、D 組、Ex tb IIIC T85°C Db  
-30°C ≤ 周囲温度 (Tamb) ≤ +75°C 過程温度 (Tprocess) ≤ 85°C  
II 級、2 区、D 組、Ex tb IIIC T100°C Db -30°C ≤ 周囲温度 (Tamb) ≤ +75°C

II 級、2 区、D 組、Ex tb IIIC T110°C Db  
-30°C < 环境温度 (Tamb) ≤ +75°C

過程温度 (Tprocess) ≤ 110°C

注意：周囲の环境温度より 5°C 高い場合に適した電源コードを使用します。

### ATEX 本質安全認証

II 級、1 区、G 組、Ex ia IIC T4 Ga

-30°C ≤ 环境温度 (Tamb) ≤ +60°C

過程温度 (Tprocess) = 105°C

電気パラメーター：Ui = 30 V、Ii = 93 mA

Pi = 1 W、Ci = 5 nF、Li = 0.5 mH

II 級、1 区、D 組、Ex ia IIIC T105°C Da

-30°C ≤ 环境温度 (Tamb) ≤ +60°C

過程温度 (Tprocess) = 105°C

電気パラメーター：Ui = 30 V、Ci = 5 nF、Li =

0.5mH

### NEPSI 隔爆認証

Ex d IIC T6 Gb; Ex tD A21 T85°C 過程温度 (Tprocess) = 80°C

### NEPSI 本質安全認証

Ex ia IIC T4 Ga -40°C ≤ 环境温度 (Tamb) ≤ +60°C

過程温度 (Tprocess) = 105°C

電気パラメーター：Ui=30V, Ii=100mA, Pi=1W, Ci=13nF,

Li=0.5mH

注意：周囲の环境温度より 5°C 高い場合に適した電源コードを使用します。

### IECEX 隔爆認証

Ex d IIC T6 Ga/Gb -30°C ≤ 环境温度 (Tamb) ≤ +75°C

過程温度 (Tprocess) ≤ 85°C

Ex d IIC T5 Ga/Gb -30°C < 环境温度 (Tamb) <

+80°C 過程温度 (Tprocess) < 100°C

Ex d IIC T4 Ga/Gb -30°C ≤ 环境温度 (Tamb) ≤

+80°C 過程温度 (Tprocess) ≤ 110°C

Ex tb IIIC T85°C Db -30°C ≤ 环境温度 (Tamb) ≤

+75°C 過程温度 (Tprocess) ≤ 85°C

Ex tb IIIC T100°C Db -30°C ≤ 环境温度 (Tamb)

≤ +75°C 過程温度 (Tprocess) ≤ 100°C

Ex tb IIIC T110°C Db -30°C ≤ 环境温度 (Tamb) ≤

+75°C

過程温度 (Tprocess) ≤ 110°C

注意：周囲の环境温度より 5°C 高い場合に適した電源コードを使用します。

### IECEx 本質安全認証

Ex ia IIC T4 Ga  $-30^{\circ}\text{C} \leq \text{環境温度}(T_{\text{amb}}) \leq +60^{\circ}\text{C}$   
 過程温度( $T_{\text{process}}$ ) =  $105^{\circ}\text{C}$   
 電気パラメーター:  $U_i = 30 \text{ V}$ ,  $I_i = 93 \text{ mA}$ ,  
 $P_i = 1 \text{ W}$ ,  $C_i = 5 \text{ nF}$ ,  $L_i = 0.5 \text{ mH}$   
 Ex ia IIIC T105°C Da  
 $-30^{\circ}\text{C} \leq \text{環境}(T_{\text{amb}}) \leq +60^{\circ}\text{C}$   
 過程温度( $T_{\text{process}}$ ) =  $105^{\circ}\text{C}$   
 Ex ic IIC T4 Gc  $-30^{\circ}\text{C} \leq \text{環境温度}(T_{\text{amb}}) \leq +60^{\circ}\text{C}$   
 過程温度( $T_{\text{process}}$ ) =  $110^{\circ}\text{C}$   
 電気パラメーター:  $U_i = 30 \text{ V}$ ,  $C_i = 5 \text{ nF}$ ,  $L_i = 0.5 \text{ mH}$

### 電磁両立性(EMC)

EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013,  
 EN 61326-2-5: 2013, 電磁両立性指令: 2014/30/EU

### UKN認証

KGE'8372: <4232'Rctw'3/9.UKN5

### RoHS 認証

EN 50581:2012, EN 62321:2013

### 調整方法

HART 手操作、その場でスイッチを押す  
 手操作はおよそ全てのパラメータを調整することができます。その場でスイッチを押すことで、伝送器に対し各種機能を調整できます: ゼロ調整、加圧及び不加圧の測定上下限数値の設定、単位選択、ダンピング設定、出力選択等。

### 画面表示

標識	説明
PV	メイン画面は過程変量を表示、 副画面はパーセンテージとプログレスバーを表示
mA	メイン画面は電流値を表示、 副画面はパーセンテージとプログレスバーを表示
%	メイン画面はパーセンテージを表示、 副画面はパーセンテージとプログレスバーを表示

### R (Ω) 負荷抵抗

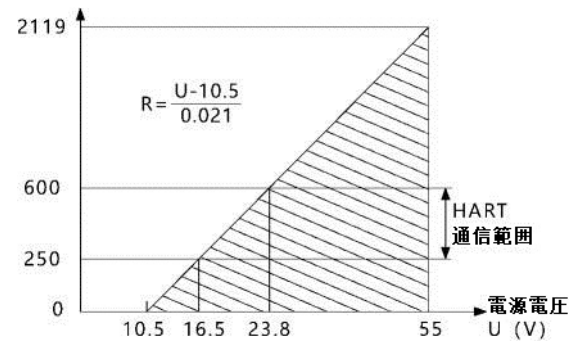


图 1 電源及び負荷条件

### 最大使用圧力及び耐圧

測定範囲	静圧範囲	単向高压側 超負荷	単向低压側 超負荷
6kPa	25MPa	25MPa	16MPa
40kPa	40MPa	25MPa	16MPa
250kPa	40MPa	25MPa	16MPa
1MPa	40MPa	25MPa	16MPa
3MPa	40MPa	25MPa	3MPa
10MPa	40MPa	25MPa	3MPa

表 1 最大使用圧力及耐圧


標準とテスト基準条件により、線型性、遅延、重複性を含む。校正温度: $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$	
線型性	$\pm 0.075\%$ , $\text{TD} > 10$ であれば、 $\pm (0.0075 \times \text{TD})\%$ となる
出力精度	$\pm 0.1\%$ , $\text{TD} > 10$ であれば、 $\pm (0.01 \times \text{TD})\%$ となる
平方根出力精度は以上の線型性パラメータ精度の 1.5 倍	
注 1: $\text{TD} = \text{最大測定スパン} / \text{調整スパン}$	

表 2 参考精度


外形寸法図 (単位 : mm)




表示機能付き本体寸法図

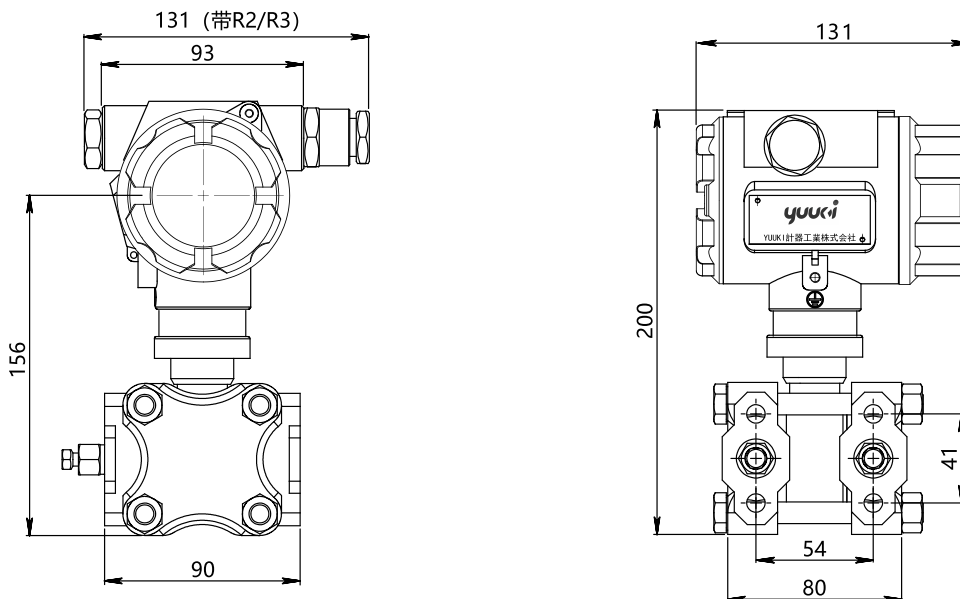


表示機能なし本体寸法図

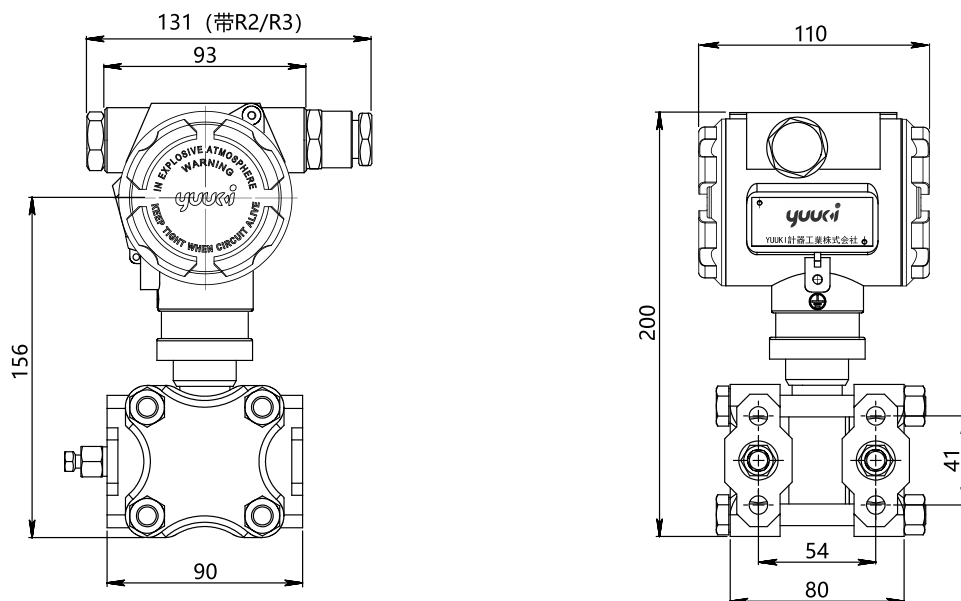


パイプ型曲スタンド取付寸法図

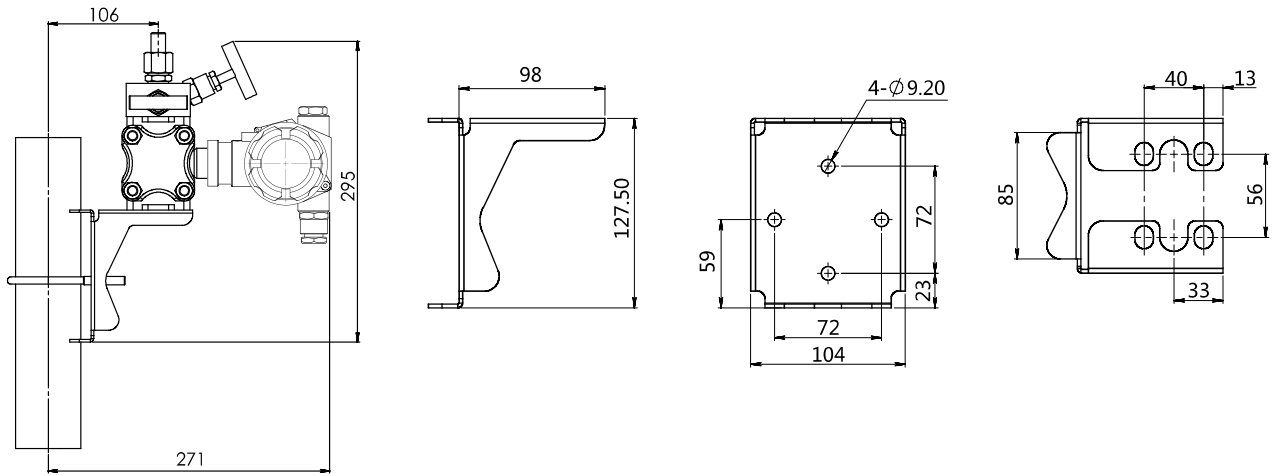

プレート型曲スタンド取付寸法図

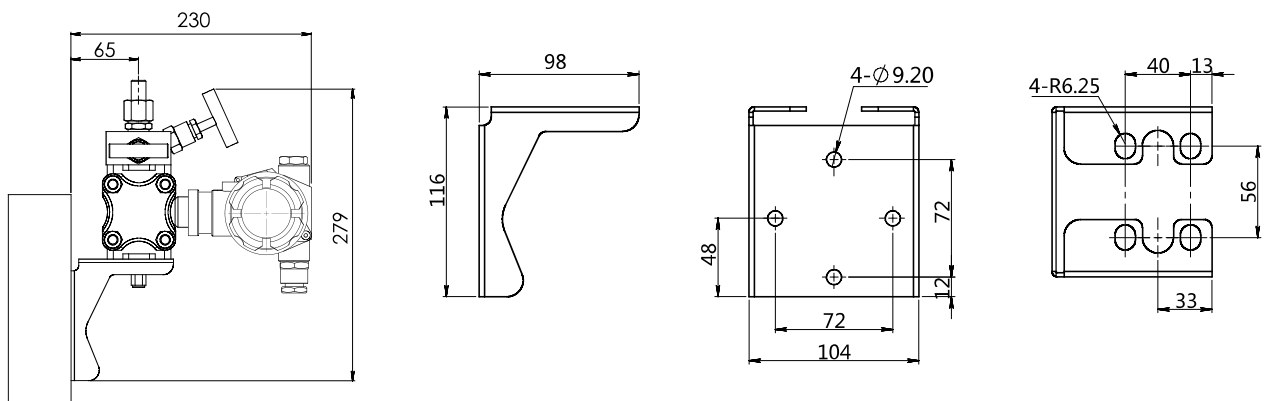

パイプ型平スタンド取付寸法図

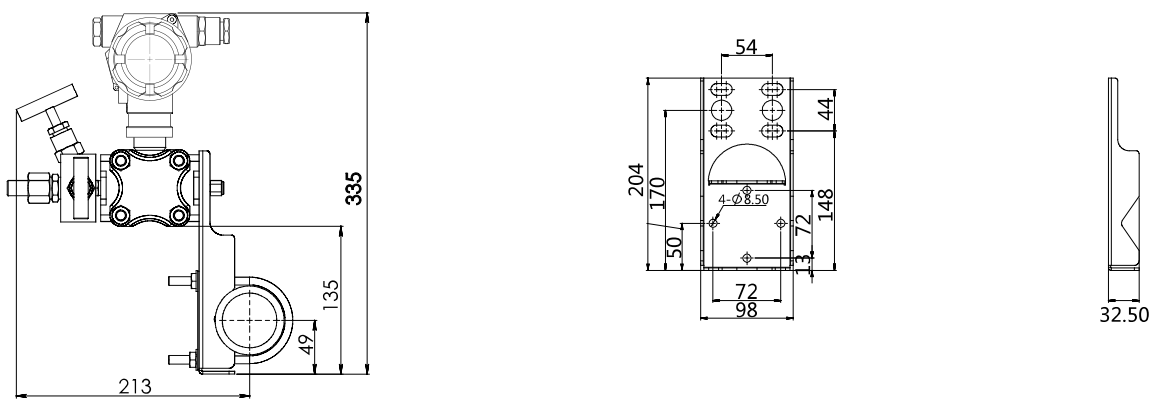

選型表

番号	項目	コード	内容
1	型号	JUN-E60	多パラメータ差圧伝送器
2	精度	B	±0.075%
		C	±0.1%
3	測定スパン	G06	0-6kPa,最小測定スパン 200Pa (0~1kPa 測定スパンは微差圧伝送器を選んで下さい)
		G40	0~40kPa,最小測定スパン 400Pa
		G250	0~250kPa,最小測定スパン 2.5kPa
		G1K	0~1MPa,最小測定スパン 10kPa
		G3K	0~3MPa,最小測定スパン 30kPa
		G10K	0~10MPa,最小測定スパン 100kPa
4	通信方式	H	4~20mA+HART,両線制
		M	パルス出力
		R	RS485 MODBUS-RTU
5	防爆	N	防爆機能無し
		G	PCEC 耐圧防爆
		D	NEPSI 耐圧防爆
		A	NEPSI 本質安全
		E	ATEX 耐圧防爆
		B	ATEX 本質安全
		M	IECEX 耐圧防爆
		W	IECEX 本質安全
6	表示	O	OLED 表示
7	接液部膜材質	S	316L ステンレス
		U	316L ステンレスメッキ
		H	ハルメタル C
8	O 型密封リンク材質	N	ニトリルゴム
		F	フッ素ゴム
		P	テフロン

番号	項目	コード	内容
9	封入液	S	シリコンオイル, 直接接触温度適応範囲-40~120℃
		D	不活性充填液, 直接接触温度適応範囲-45~160℃
10	接液部処理	0	特別処理無し
		1	禁油処理
		2	禁水処理
11	圧力導入接続	H1	プロセス接続雌ネジ 1/4T8NPT,排気排液弁はフランジの後部に位置する
		H2	プロセス接続雌ネジ 1/4T8NPT,排気排液弁はフランジの側面下部に位置する
		H3	プロセス接続雌ネジ 1/4T8NPT,排気排液弁はフランジの側面上部に位置する
		H4	垂直にフランジを組合せる, プロセス接続雌ネジ 1/4-18NPT,排気排液弁はフランジの側面に位置する
12	配線接続	T1	M20*1.5 雌ネジ 2 個
		R1	M20*L5 雌ネジ電気接口 2 個, 片側は M20*1.5 防水接口, 片側は PVC 材質プラグにセットする
		R2	片側雌ネジ 1/2NPT に,片側はステンレスプラグにセットする
		R3	片側雌ネジ M20*1.5,片側はステンレスプラグにセットする
13	付加選択肢-圧力導入接続部品	-A1	接口 M20*1.5 に転する、雄ネジ及び引抜パイプΦ 14*2*30, 304 ステンレス
		-A2	接口 1/2T4NPT に転する、雌ネジ, 304 ステンレス
14	付加選択肢-固定取付部品	-B1	2"パイプ型曲ブラケット
		-B2	フラット型曲ブラケット
		-B3	2"パイプ型平ブラケット
		-B4	U型ブラケット, 2"パイプ取付
15	付加選択肢-熔接管接続口	-C	1/2NPT はΦ14 に転して、パイプ接口を溶接する
16	付加選択肢-弁セット	-3	三弁組, 304 ステンレス
		-4	三弁組, 316 ステンレス
		-5	五弁組, 304 ステンレス
		-6	五弁組, 316 ステンレス
17	付加選択肢-校正報告	-S	SIL認証

### 注意事項

伝送器の提供する機能をより良く発揮させるため、ご使用前の下記事項を注意し、説明書を閲覧するようお願いいたします。

### 伝送器取り付け注意事項

#### ⚠ 注意

伝送器を取り付ける際、密封パッキングの嵌めるプロセス接続部で、伝送器とプロセス流体（例フランジ接続部、接続管道、フランジ）の接続部位を確実に突き出さないようにしてください。万が一、密封パッキングが外側に突き出していると、液体漏洩と出力エラーを起こしてしまう可能性があります。伝送器の規定圧力と温度範囲を超過時、製品規格の操作条件以外の状況においては、絶対に伝送器を使用しないでください、製品の漏洩で重大事故に繋がる可能性があります。危険区域内で配線工事を行う際、防爆標準指導書にある操作方法を遵守しながら工事を行うようご注意ください。

#### ⚠ 注意

取り付してある伝送器の上に立たないでください。足踏み台にすると、流体が噴出され、人員の怪我を招いてしまう可能性があります。ガラスディスプレイの取り扱いにご注意ください、工具などでディスプレイのガラス部分を叩かないでください、砕かれたガラスの破片は体の怪我に繋がるかもしれません。伝送器は重いので、安全靴を履いたうえでお取り付けするようご注意ください。伝送器を衝突するとセンサの故障を起こしてしまうかもしれません。

### 接線注意事項

#### ⚠ 警告

電線ショートを防ぐ為に、濡れた手や帯電の状態での配線作業をしないでください。

#### ⚠ 注意

技術規格書に従って正確に接続してください、接続間違えると器械の故障と重大な損失を引き起こしてしまいます。

技術規格書に適合した電源をご使用ください、不適切な電源を使用してしまいますと、器械の故障と重大な損失を引き起こしてしまいます。

### HART 協議設備注意事項を使用する

- 補助機（HART 通信機等）でメーターを操作する際に、サーバー（DOS 設備管理システム）の通信間隔時間を 8 秒以上に設置してください、或いはサーバーからメーターへの通信を停止してください。もしサーバーは 8 秒以内にメーターと繰り返し HART 通信をしてしまうと、メーターは補助機の要請を受信できないかもしれません。
- 周囲環境の電器騒音でサーバーとの HART 通信に影響してしまいますと、相応措置を取ってください。例えばシグナルケーブルと騒音源を分離すること、アースを改善すること、或いは電波を取り替えることによってシグナルケーブルを遮断する等。4-20Ma の模擬信号を採用するとたとえ HART 通信が騒音の妨害を受けたとしても、使用には影響がございません。

⚠ 本商品を使用する前に、操作マニュアルを熟読してください。

⚠ 改良の理由で、一部の外見或いは規格が少し変化がある場合も、別途で通知しません。